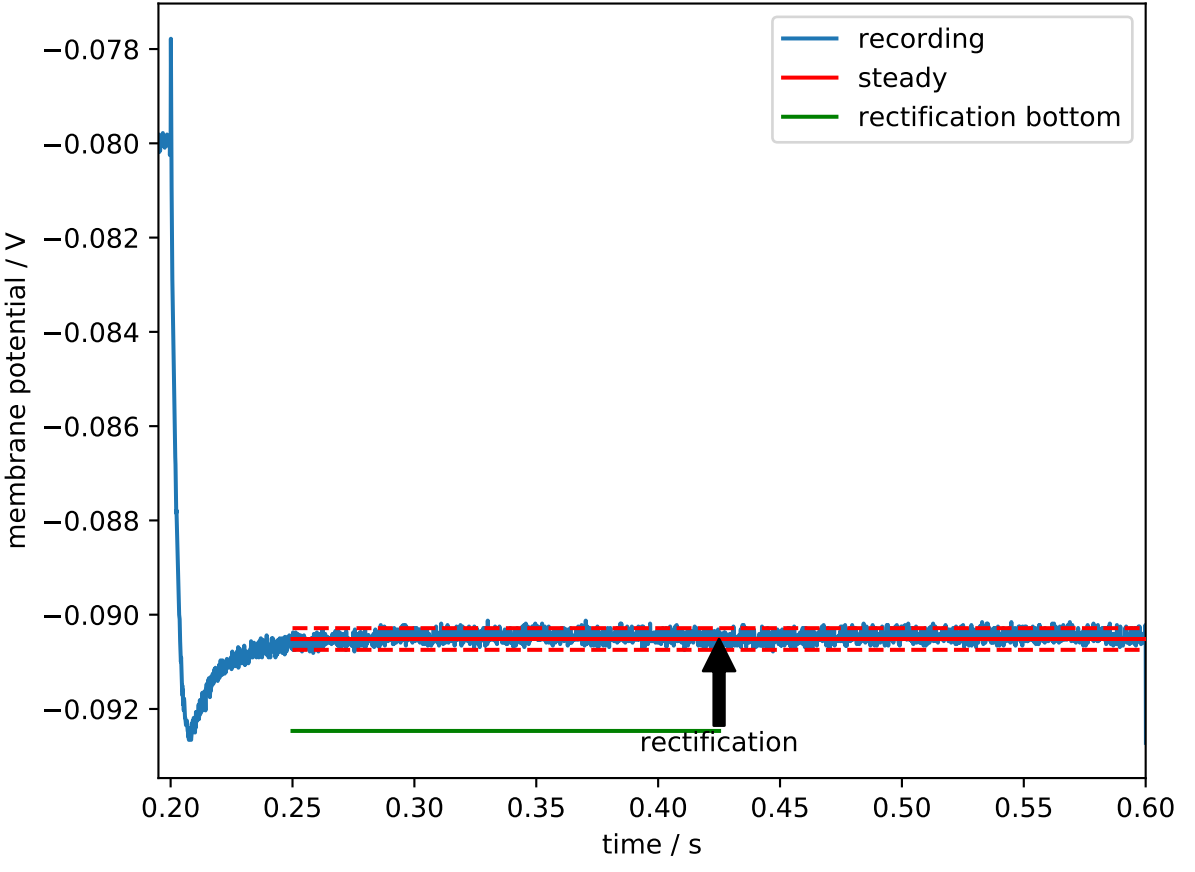
recording
steady
rectification bottom
rectification
membrane potential / V
time / s
−0.078
−0.080
−0.082
−0.084
−0.086
−0.088
−0.090
−0.092
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60