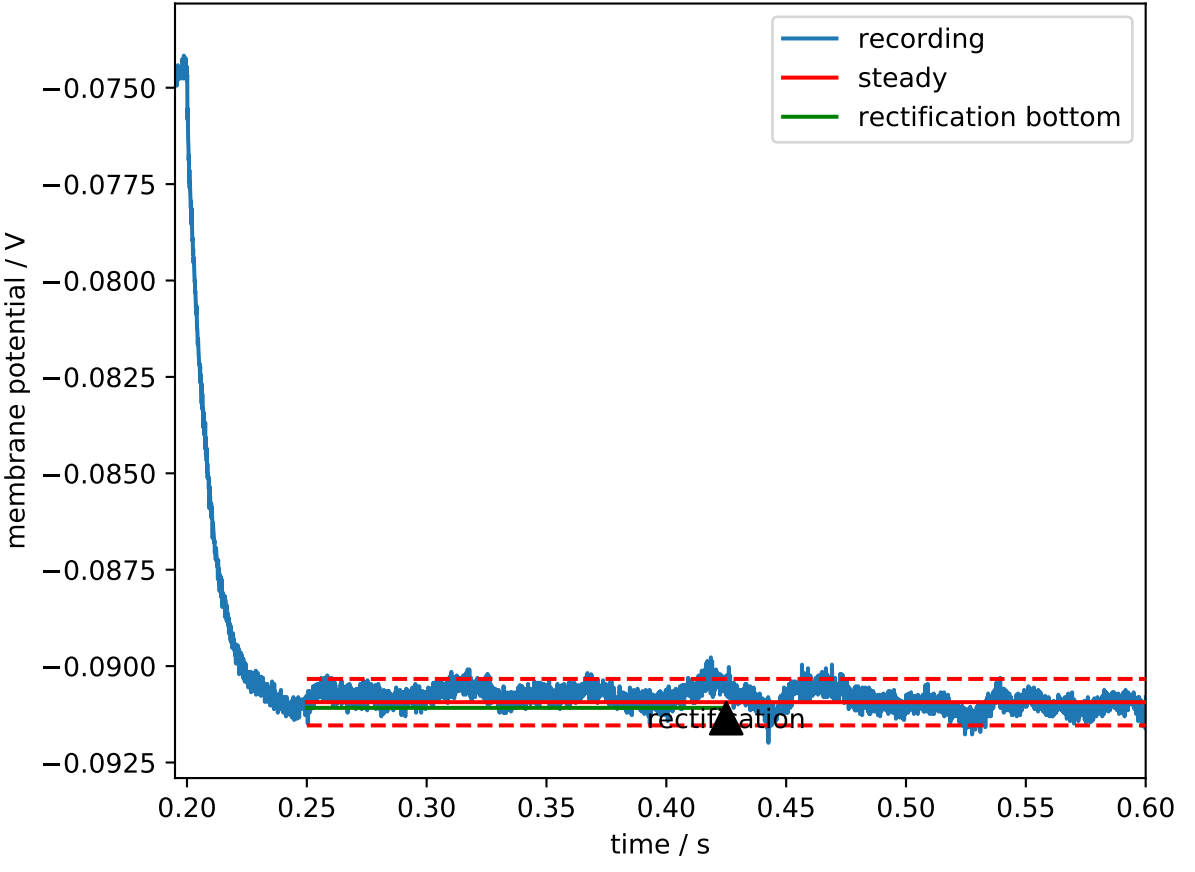
recording
steady
rectification bottom
rectification
membrane potential / V
−0.0750
−0.0775
−0.0800
−0.0825
−0.0850
−0.0875
−0.0900
−0.0925
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
time / s