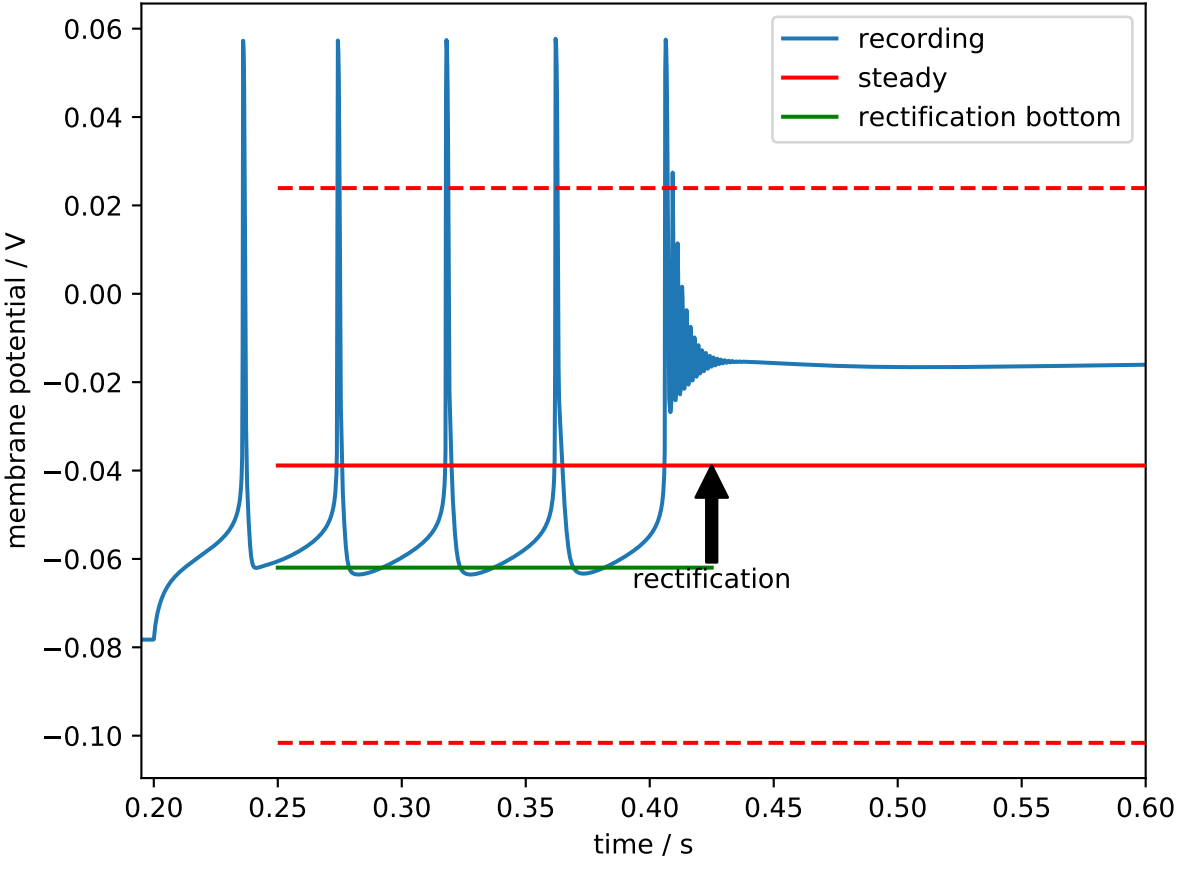
recording
steady
rectification bottom
rectification
membrane potential / V
time / s
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
−0.08
−0.10
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60