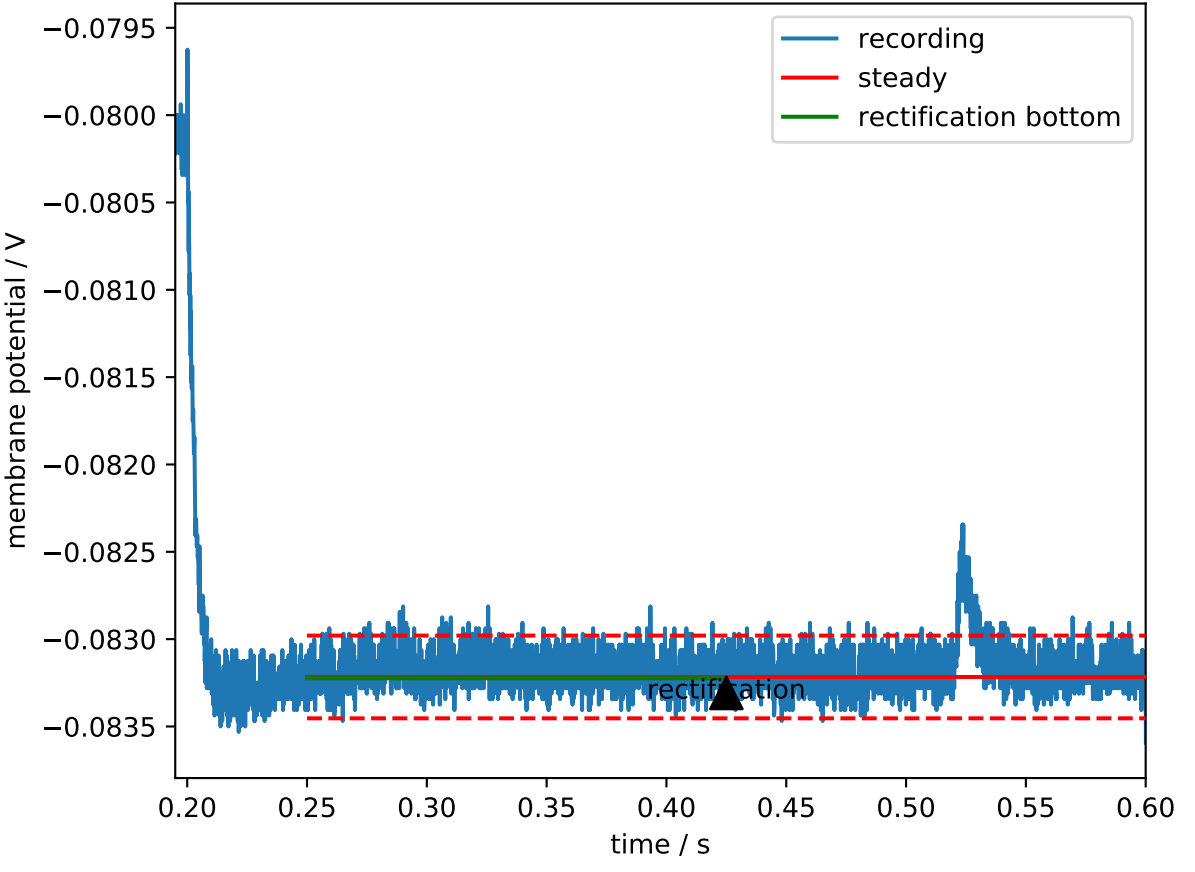
recording
steady
rectification bottom
rectification
membrane potential / V
time / s
−0.0795
−0.0800
−0.0805
−0.0810
−0.0815
−0.0820
−0.0825
−0.0830
−0.0835
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60