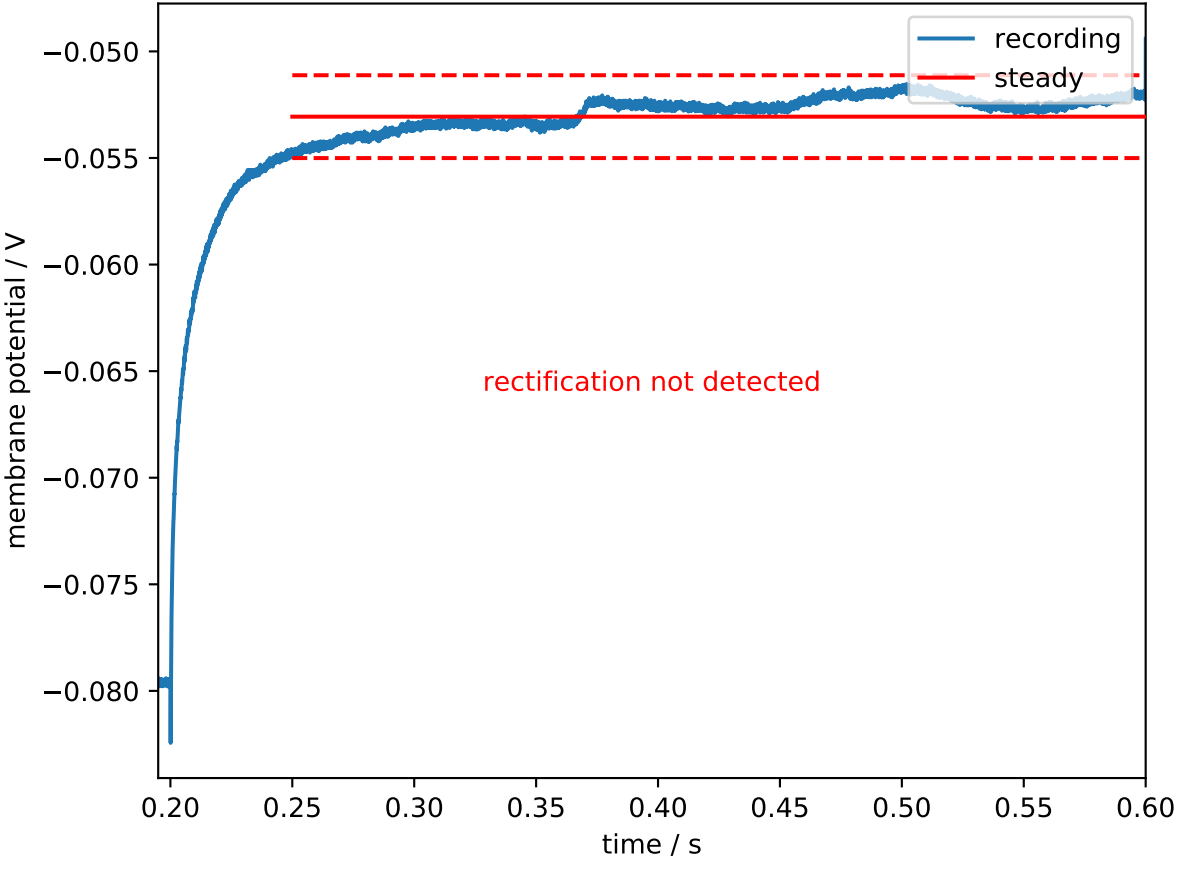
recording
steady
rectification not detected
membrane potential / V
time / s
−0.050
−0.055
−0.060
−0.065
−0.070
−0.075
−0.080
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60